


メンテ
ナンス

■エレベーション®パッドの調整方法

エレベーションパッド内の空気量は時間経過によって減少していきます。
以下の手順にしたがって、空気量を調整してください。

①ピロケース裏側、両サイドエリアのファスナーを開けて、エレベーションパッド(2枚)を取り出します。


②エレベーションパッド(2枚)の空気注入口を開けて、空気を吹き込みます。



③ショルダーポイントを手のひらで押したときに、
少し弾力が残る程度が空気量の目安です。



④空気注入口は以下の要領で、エレベーションパッドに押し込みます。

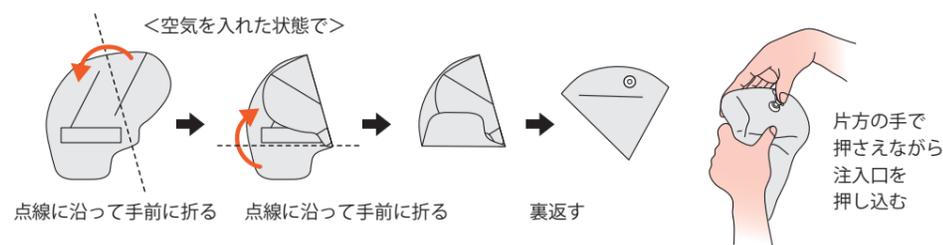

⑤空気注入口が枕の底面にくるように、エレベーションパッドをピロケースにセットしてご使用ください。



エレベーションピローをご購入いただき、誠にありがとうございます。

エレベーション®ピローの特長

お取扱いの手引き

メンテナンス

●本体・ピロケースの洗濯方法

- ①ピロケース裏のファスナーから、本体、エレベーションパッド(2枚)を取り出します。
- ②洗濯機、または手洗いで洗濯してください。
- ③洗濯後は風通しの良い所で干してください。
※タンブラー乾燥はお避けください。
(詳しくはそれぞれの洗濯表示に基づいて洗濯してください。)

●取扱上の注意

- ・無理な姿勢での使用はおやめください。
- ・クッション、座布団等、枕以外での使用はおやめください。
- ・曲げたり、乱暴に扱ったりしないでください。
- ・ピロケースや本体に汚れが付着した時は、速やかに洗濯してください。
- ・頸椎などに疾患がある方は、必ず医師に相談の上で使用ください。

エレベーション®ピロー Elevation®Pillow

仕様

- ・製品サイズ 縦約40cm×横約58cm×高さ約7.5cm
- ・ピロケース
側地：(表・裏地)ポリエステル100%
(繋ぎ部分)ナイロン83%/ポリウレタン17%
(中当)ポリエステル100%
- パッド：PVC(エレベーションパッド)
- ・本体
側地：綿100%
- 詰めもの：ポリエチレンパイプ(フロービーズ)
- ・付属品 ポリエチレンパイプ(補充用フロービーズ)

<製造元>

ナオ・シング株式会社

埼玉県比企郡川島町吹塚760-2 ☎0120-376-933

<http://www.nao-thing.co.jp>

ASMOT®

www.asmot.jp


エレベーション®ピローの特長

仰向け時と横向き時では枕の必要な高さは異なります。

枕が姿勢に合わせて昇降することで理想的な寝姿勢に導きます。

エレベーションピローは空気の利用した独自開発 (PAT.PEND.) の高さ調節機能で、快適な睡眠をもたらします。

●新開発のエレベーションパッドが、寝姿勢に合わせて枕の高さを自動調整します。

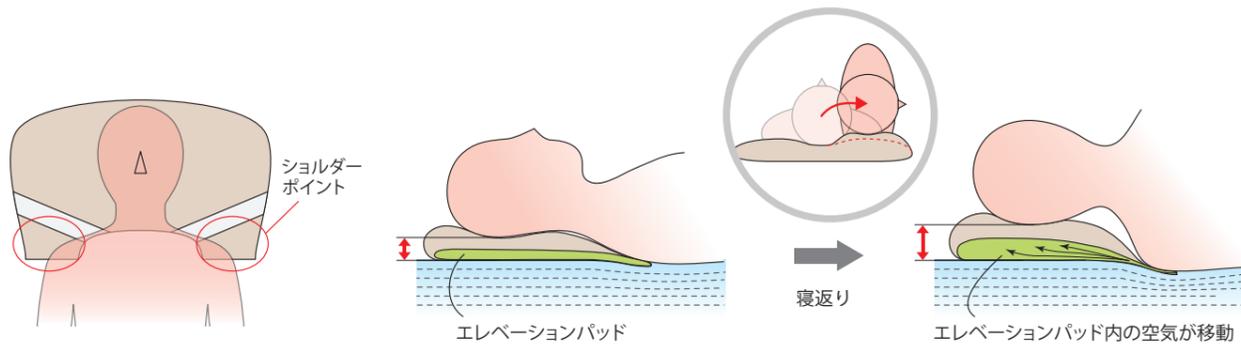


正しい枕のポジション

横向きになる寝姿勢に合わせてサイドエアがスムーズに持ち上がる

枕の左右両サイド内部のエアパッド(エレベーションパッド)により、横向き時の体重移動に合わせて、枕のサイドエアがスムーズに持ち上がります。

仰向け時、横向き時、寝返りに合わせて枕の高さが昇降しますので、頸椎部に負担の少ない寝姿勢を保ちます。

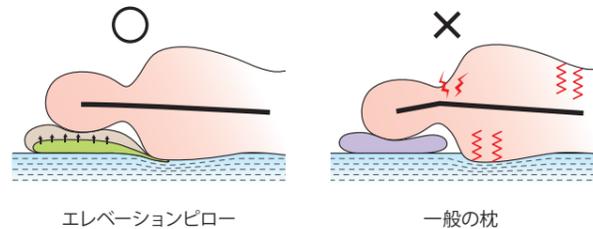


エレベーションピロー

一般の枕

●快適素材の三層構造で心地よく頭部を支えます。

- ①枕表面にはクッション性、通気性にすぐれた立体メッシュ、表生地には肌ざわりの良い吸水速乾性に優れたニット生地を使用。
- ②中材には、通気性と流動性に優れたフロービーズを使用。身体のラインに合わせて動き、フィット感を高めます。
- ③エレベーションパッドのエアークッションが、横向き時には頭部の重さをソフトに受け止め、仰向け時にはサポート性を高めます。

①立体メッシュ ②フロービーズ ③エレベーションパッド

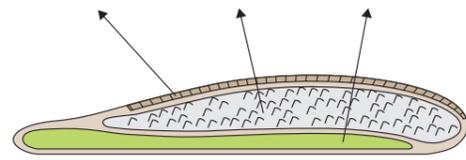


断面図

●中材のフロービーズは、本体のファスナー口から出し入れ可能なので、お好みの高さに調整が可能です。

●本体、ピロケース共に洗濯が可能なのでお手入れも簡単です。

お取扱いの手引き

まず、各部品がもれなくセットされていることをご確認ください。

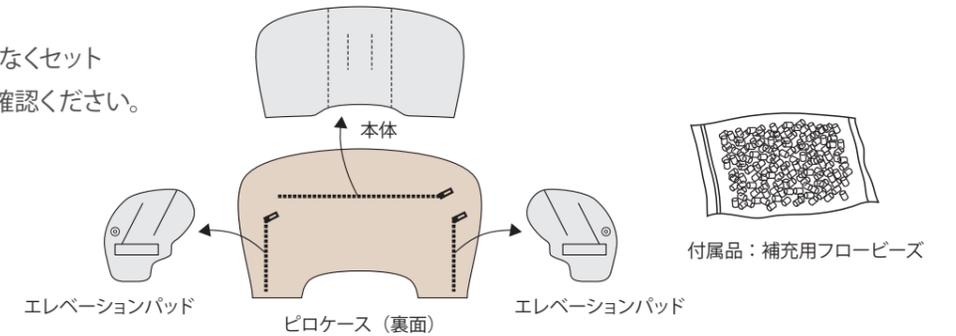

快適にお使いいただくために

以下の手順にしたがって、高さ(フロービーズ量)の調整を行ってください。

A 仰向け時の調整

- ①実際にご使用される場所に、セットされたエレベーションピローを置き、ショルダーポイントに両肩を乗せるようにして、仰向けに寝てください。(図1)
- ②仰向けの状態で首を左右に振り、枕が頭部の形になじむようにしてから真上を向きます。(図1)
- ③その時高く感じるようであれば、ピロケースから本体を取り出し、頭部エリアのファスナーを開けて、フロービーズを少し抜いてください。(図2)
- ④逆に低く感じられるようであれば、付属のフロービーズを足して、お好みの高さに調整してください。(図2)

図1


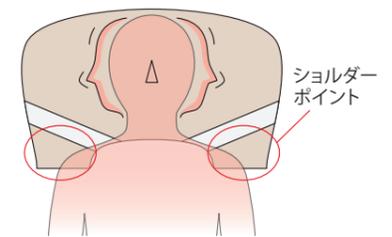


図2

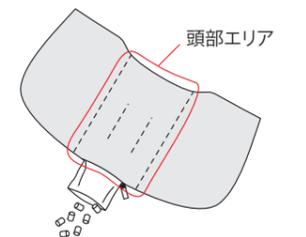

B 横向き時の調整

- ① A-①と同じ
- ②肩をショルダーポイントに当たるようにして寝返りを打ち、枕のサイドエアが持ち上がるかを確認します。(図3)
※サイドエアがスムーズに持ち上がらない場合は、裏面の「エレベーションパッドの調整方法」をご参照ください。
- ③そのとき高すぎると感じるようであれば、ピロケースから本体を取り出し、本体サイドエアのファスナーを開けて、フロービーズを少し抜いてください。(図4)
- ④逆に低く感じられるようであれば、付属のフロービーズを足して、お好みの高さに調整してください。(図4)
※首から頭へのラインが水平になる位が自然な寝姿勢の目安です。

図3


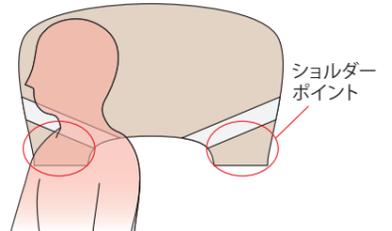


図4



フロービーズの量を調整
エレベーションパッド

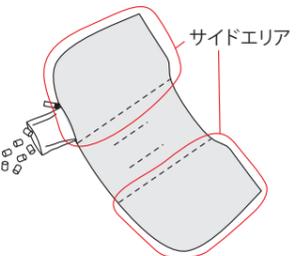